



Zastrzeża się prawo drobnych zmian w układzie.

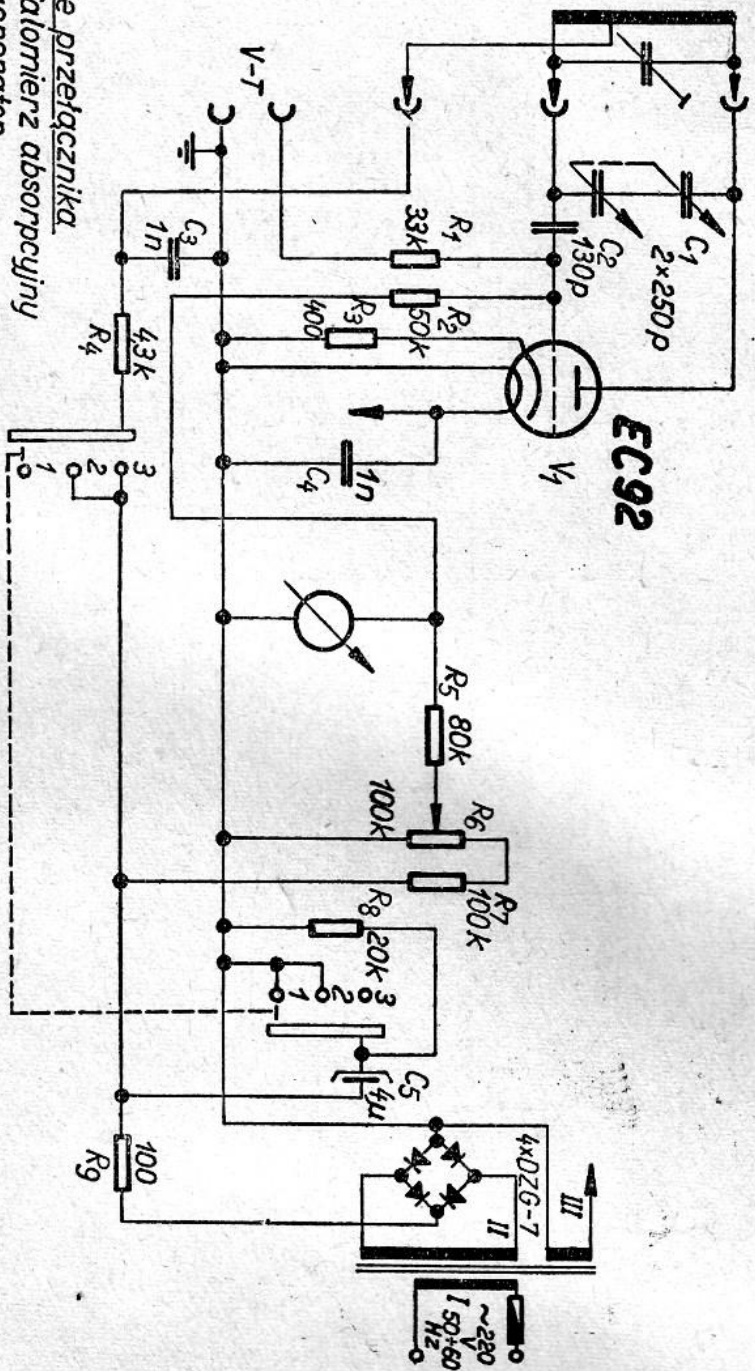

- Pozycje przełącznika
1. FA (Wfalomierz absorpcyjny)
2. G – generator
3. AM – generator z amplitudą modulowaną – 100 Hz.

Rys. 1. Falomierz-generator typ RF6-2

Zastrzeżona się możliwość drobnych zmian w układzie.

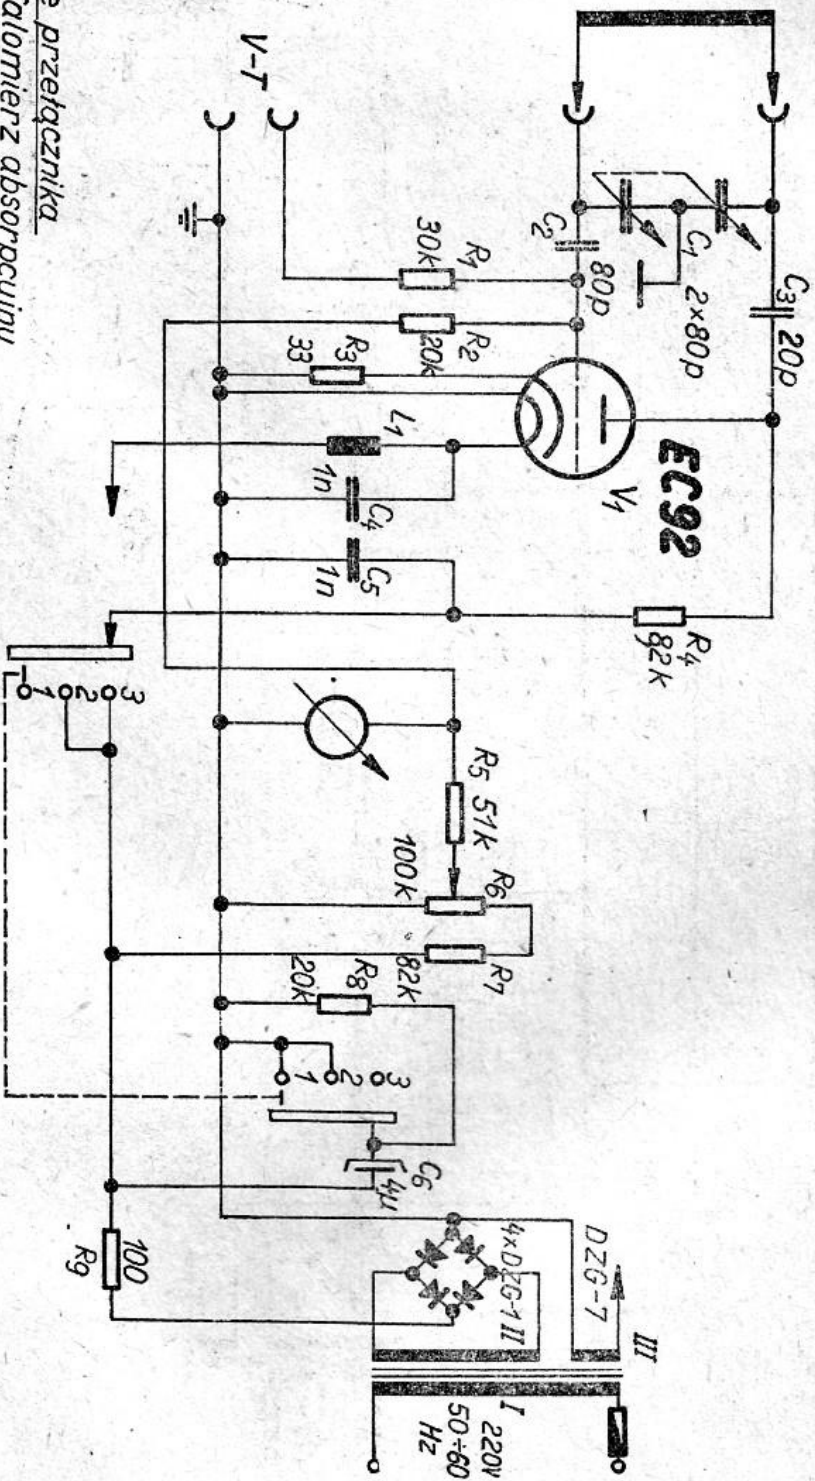

Pozycje przełącznika

- 1.FA(VM) falomierz absorpcyjny
- 2.G – generator
- 3.AM – generator z amplitudą modulowaną – 100 Hz.

Rys. 2. Falomierz-generator typ UFG-2